

**RAPPORT VAN HERIJK
RAPPORT DE VERIFICATION PERIODIQUE**

Noordlaan 7 - B-8820 TORHOUT - TEL 050/21.25.47 - FAX 050/21.69.03
H.R.O. 37.741 - B.T.W. BE 0423.325.915 - Reg. Nr. 0423.325/915/05/23/11

Oprichtgever : **MATTHEEUWS ERIC**
Donneur d'ordre **NIJVERHEIDSSTRAAT 2
8630 VEURNE**

Plaats van inspectie : **NIJVERHEIDSSTRAAT 2
8630 VEURNE**
Lieu de l'inspection

BTW/TVA : **BE 0441.995.940**
Datum van de inspectie : **12/11/2020**
Date de l'inspection

Rapport nummer : **P008/130/321300152/N07429**
Rapport numéro

Kenmerken van het toestel/Caractéristiques de l'appareil :

Merk/Marque : **ROBBE**
Type : **9306 WB-529-VE-6**

Goedkeuringsnr.: **B-95-104015 B-96-104087**
No.d'approbation

Fabricatie- of serienr. : **17005 CE08**
No.de fabrication ou de série

Max : **30 000/60 000 kg**
Min : **200/400 kg**
e : **10/20 kg**

Klasse : **III**
Classe

Beschrijving opdracht en uitgevoerde werken/Description de l'ordre et des travaux effectués :

Inspectie code : **H** Periodieke herijk door keuringsinstelling
Code de l'inspection Vérification périodique par organisme d'inspection
Uitvoeren 4-jaarlijkse herijk

Proeven/Essais - Bereik 1

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Weegproeven zonder tarra/Performances de pesage sans tare | : Goedgekeurd/Accepté |
| 2. Weegproeven met tarra/Performances de pesage avec tare | : Niet uitgevoerd/Non effectué |
| 3. Proeven met excentrische belasting/Excentration | : Goedgekeurd/Accepté |
| 4. Beweeglijkheidsproeven/Mobilité | : Niet uitgevoerd/Non effectué |
| 5. Herhaalbaarheidsproeven/Fidélité | : Niet uitgevoerd/Non effectué |

Proeven/Essais - Bereik 2

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Weegproeven zonder tarra/Performances de pesage sans tare | : Goedgekeurd/Accepté |
| 2. Weegproeven met tarra/Performances de pesage avec tare | : Niet uitgevoerd/Non effectué |
| 3. Proeven met excentrische belasting/Excentration | : Goedgekeurd/Accepté |
| 4. Beweeglijkheidsproeven/Mobilité | : Niet uitgevoerd/Non effectué |
| 5. Herhaalbaarheidsproeven/Fidélité | : Niet uitgevoerd/Non effectué |

Wind/Vent	: Normaal/Normal
Neerslag/Precipitations	: Geen/Aucun
Waterpasstelling/Mise à niveau	: Niet van toepassing/Pas applicable
Voorbelasting/Charge préalable aux essais (III of IIII)	: Niet uitgevoerd/Pas exécuté

Bemerkingen/Remarques

Geen tarra-inrichting aanwezig/Pas de dispositif de tare.
Nr. groen ijkvignet/N^o Vignette de vérification : P008/00160 (Type F)
Geldig tot/Valide jusqu'à 12/11/2024
Fout bij proef 1 < 1/2 MTF : geen proef 5//Erreur essai 1 < 1/2 EMT : pas d'essai 5.

Ondervermelde gegevens zijn niet gewaarborgd door de Belacaccreditatie maar onderworpen aan een toezicht van de Metrologische Dienst.
Les données ci-dessous ne sont pas couvertes par l'accréditation Belac mais soumises à une surveillance par le Service de la Métrologie.
Dit inspectieverslag geldt als ijkcertificaat./Ce rapport tient lieu de certificat de vérification.

Besluit/Conclusion

Het toestel stemt overeen met de TEC/TAC of het modelgoedkeuringsdossier	: Ja
L'instrument est conforme au TEC/TAC ou au dossier d'approbation	: Oui
Het toestel stemt overeen met de instructie E63100-4-C01	: Ja
L'instrument est conforme aux exigences de l'instruction E63100-4-C01	: Oui
Aantal gebruikte verzegelingsvignettes Nombre de vignettes de scellement	: 1
Naam van de inspecteur Nom de l'inspecteur	: Stijn Deswaef
Elektronische handtekening/Signature électronique	

Resultaten herijk (Klant)
Résultats vérification périodique (Client)

Noordlaan 7 - B-8820 TORHOUT - TEL 050/21.25.47 - FAX 050/21.69.03
H.R.O. 37.741 - B.T.W. BE 0423.325.915 - Reg. Nr. 0423.325/915/05/23/11

Contactpersoon : **STEEFAAN MERLAEN**

Identificatienr. :

Personne de contact :

N° d'identification :

Nulcorrectie inrichting (zero-tracking) : **Aan**

Behoort bij verslag :

P008/130/321300152/N07429

Dispositif de maintient du zéro : **Actif**

Fait partie du rapport :

Gebruikte set gewichten of jkmassa's : **E6/CTRLMN/3620/200714-RDD-001C_1T**

Jeu de masses étalons utilisées :

Proeven uitgevoerd met geijkte gewichten conform de goedkeuringsdossiers van het Ministerie van Economische Zaken - Metrologische dienst.
Essais effectués avec masses étalons conformes au dossier d'approbation du Ministère des Affaires Economiques - Services de la Métrologie.

DAK

Gegevens in : kg Données en	Resultaten/Résultats = Ic bij controle/lors du contrôle MTF = Maximaal toelaatbare fout / EMT = Erreur maximale tolérée >= Ic-L-Eo
Schaaldeel bij de proeven : 1 kg Echelon utilisé pour l'essai	


Proef / Essai 1 : Weegproeven zonder tarra / Performances de pesage sans tare (EN 45501 : A.4.4)


Fout bij nul = Eo moet steeds kleiner zijn dan 1/4e / Erreur près du zéro = Eo doit toujours être plus petite que 1/4e

Last Charge	Samenstelling Composition	Ic aanwijzing bij de proeven indication avec échelon utilisé pour l'essai		Ec=E-Eo gecorrigeerde fout erreur corrigée		MTF EMT
		Stijgende belasting Charge	Dalende belasting Décharge	Stijgende belasting Charge	Dalende belasting Décharge	
100		Eo=0	98	0	-2	2,5/10
200		200	198	0	-2	10
5 000		4 998	4 998	-2	-2	10
15 000		15 000	14 999	0	-1	20
20 000		19 997	20 001	-3	1	20
30 000		30 000	30 000	0	0	30

Proef / Essai 3 : Excentrische belasting / Excentration (EN 45501 : A.4.7)

Duid op de schets de plaats van de aanwijsinrichting aan (X=Indicator)

Hoekbelasting : Charge d'angle	Eo :	Positie	Ic	Ec	MTF/EMT
6 000	0				
		1	6 000	0	20
		2	6 002	2	20
		3	5 999	-1	20
		4	5 998	-2	20
		5	5 998	-2	20
		6	6 000	0	20

Rollende last : Charge roulante	Eo :	Positie	Ic	Ec	MTF/EMT
14 329	0				
		A -->	14 327	-2	20
		B -->	14 331	2	20
		C -->	14 327	-2	20
		C <--	14 327	-2	20
		B <--	14 331	2	20
		A <--	14 327	-2	20

Substitutielast Charge de substitution	Aanwijzing I	Toegevoegde last dL	Gemeten waarde G=I+1/2e-dL	Fout op dit punt E	Werkelijke last L=G-E
Last/Charge 1	29 794		29 794	10	29 784
Last/Charge 2	29 546		29 546	10	29 536

Datum/Date : **12/11/2020**

Inspecteur : **Stijn Deswaef**

Elektronische handtekening
Signature électronique

Alle informatie op dit document wordt als vertrouwelijk behandeld (Verkoopsvoorwaarden, artikel 14)./Toutes les informations sur ce document sont traitées de manière confidentielle (Conditions de vente, article 14).
Dit document mag alleen in zijn geheel gereproduceerd worden./Ce document ne peut être reproduit que dans son entièreté.

**RAPPORT VAN HERIJK
RAPPORT DE VERIFICATION PERIODIQUE**

Noordlaan 7 - B-8820 TORHOUT - TEL 050/21.25.47 - FAX 050/21.69.03
H.R.O. 37.741 - B.T.W. BE 0423.325.915 - Reg. Nr. 0423.325/915/05/23/11

Oprichtgever : **MATTHEEUWS ERIC**
Donneur d'ordre **NIJVERHEIDSSTRAAT 2
8630 VEURNE**

Plaats van inspectie : **NIJVERHEIDSSTRAAT 2
8630 VEURNE**
Lieu de l'inspection

BTW/TVA : **BE 0441.995.940**
Datum van de inspectie : **12/11/2020**
Date de l'inspection

Rapport nummer : **P008/130/321300152/N07429**
Rapport numéro

Kenmerken van het toestel/Caractéristiques de l'appareil :

Merk/Marque : **ROBBE**
Type : **9306 WB-529-VE-6**

Goedkeuringsnr.: **B-95-104015 B-96-104087**
No.d'approbation

Fabricatie- of serienr. : **17005 CE08**
No.de fabrication ou de série

Max : **30 000/60 000 kg**
Min : **200/400 kg**
e : **10/20 kg**

Klasse : **III**
Classe

Beschrijving opdracht en uitgevoerde werken/Description de l'ordre et des travaux effectués :

Inspectie code : **H** Periodieke herijk door keuringsinstelling
Code de l'inspection **H** Vérification périodique par organisme d'inspection
Uitvoeren 4-jaarlijkse herijk

Proeven/Essais - Bereik 1

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Weegproeven zonder tarra/Performances de pesage sans tare | : Goedgekeurd/Accepté |
| 2. Weegproeven met tarra/Performances de pesage avec tare | : Niet uitgevoerd/Non effectué |
| 3. Proeven met excentrische belasting/Excentration | : Goedgekeurd/Accepté |
| 4. Beweeglijkheidsproeven/Mobilité | : Niet uitgevoerd/Non effectué |
| 5. Herhaalbaarheidsproeven/Fidélité | : Niet uitgevoerd/Non effectué |

Proeven/Essais - Bereik 2

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Weegproeven zonder tarra/Performances de pesage sans tare | : Goedgekeurd/Accepté |
| 2. Weegproeven met tarra/Performances de pesage avec tare | : Niet uitgevoerd/Non effectué |
| 3. Proeven met excentrische belasting/Excentration | : Goedgekeurd/Accepté |
| 4. Beweeglijkheidsproeven/Mobilité | : Niet uitgevoerd/Non effectué |
| 5. Herhaalbaarheidsproeven/Fidélité | : Niet uitgevoerd/Non effectué |

Wind/Vent	: Normaal/Normal
Neerslag/Precipitations	: Geen/Aucun
Waterpasstelling/Mise à niveau	: Niet van toepassing/Pas applicable
Voorbelasting/Charge préalable aux essais (III of IIII)	: Niet uitgevoerd/Pas exécuté

Bemerkingen/Remarques

Geen tarra-inrichting aanwezig/Pas de dispositif de tare.
Nr. groen ijkvignet/N° Vignette de vérification : P008/00160 (Type F)
Geldig tot/Valide jusqu'à 12/11/2024
Fout bij proef 1 < 1/2 MTF : geen proef 5//Erreur essai 1 < 1/2 EMT : pas d'essai 5.

Ondervermelde gegevens zijn niet gewaarborgd door de Belacaccreditatie maar onderworpen aan een toezicht van de Metrologische Dienst.
Les données ci-dessous ne sont pas couvertes par l'accréditation Belac mais soumises à une surveillance par le Service de la Métrologie.
Dit inspectieverslag geldt als ijkcertificaat./Ce rapport tient lieu de certificat de vérification.

Besluit/Conclusion

Het toestel stemt overeen met de TEC/TAC of het modelgoedkeuringsdossier	: Ja
L'instrument est conforme au TEC/TAC ou au dossier d'approbation	: Oui
Het toestel stemt overeen met de instructie E63100-4-C01	: Ja
L'instrument est conforme aux exigences de l'instruction E63100-4-C01	: Oui
Aantal gebruikte verzegelingsvignetten Nombre de vignettes de scellement	: 1
Naam van de inspecteur Nom de l'inspecteur	: Stijn Deswaef
Elektronische handtekening/Signature électronique	

Alle informatie op dit document wordt als vertrouwelijk behandeld (Verkoopsvoorwaarden, artikel 14)./Toutes les informations sur ce document sont traitées de manière confidentielle (Conditions de vente, article 14).
Dit document mag alleen in zijn geheel gereproduceerd worden./Ce document ne peut être reproduit que dans son entiereté.

Resultaten herijk (Klant)
Résultats vérification périodique (Client)

Noordlaan 7 - B-8820 TORHOUT - TEL 050/21.25.47 - FAX 050/21.69.03
H.R.O. 37.741 - B.T.W. BE 0423.325.915 - Reg. Nr. 0423.325/915/05/23/11

Contactpersoon : **STEEFAAN MERLAEN**

Identificatienr. :

Personne de contact :

N° d'identification :

Nulcorrectie inrichting (zero-tracking) : **Aan**

Behoort bij verslag :

P008/130/321300152/N07429

Dispositif de maintient du zéro : **Actif**

Fait partie du rapport :

Gebruikte set gewichten of jkmassa's : **E6/CTRLMN/3620/200714-RDD-001C_1T**

Jeu de masses étalons utilisées :

Proeven uitgevoerd met geijkte gewichten conform de goedkeuringsdossiers van het Ministerie van Economische Zaken - Metrologische dienst.
Essais effectués avec masses étalons conformes au dossier d'approbation du Ministère des Affaires Economiques - Services de la Métrologie.

DAK

Gegevens in : kg Données en	Resultaten/Résultats = Ic bij controle/lors du contrôle MTF = Maximaal toelaatbare fout / EMT = Erreur maximale tolérée >= Ic-L-Eo
Schaaldeel bij de proeven : 2 kg Echelon utilisé pour l'essai	

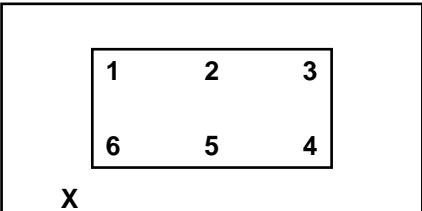
Proef / Essai 1 : Weegproeven zonder tarra / Performances de pesage sans tare (EN 45501 : A.4.4)

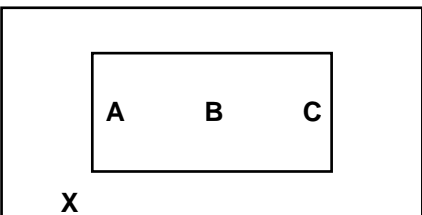
Fout bij nul = Eo moet steeds kleiner zijn dan 1/4e / Erreur près du zéro = Eo doit toujours être plus petite que 1/4e

Last Charge	Samenstelling Composition	Ic aanwijzing bij de proeven indication avec échelon utilisé pour l'essai		Ec=E-Eo gecorrigeerde fout erreur corrigée		MTF EMT
		Stijgende belasting Charge	Dalende belasting Décharge	Stijgende belasting Charge	Dalende belasting Décharge	
200		Eo=0	198	0	-2	5/20
400		400	396	0	-4	20
10 000		10 000	10 000	0	0	20
20 000		20 004	20 006	4	6	40
30 000		30 010	30 010	10	10	40
29 784		29 794	29 792	10	8	40
39 784		39 792	39 796	8	12	40
49 784		49 800	49 798	16	14	60
59 784		59 798	59 796	14	12	60

Proef / Essai 3 : Excentrische belasting / Excentration (EN 45501 : A.4.7)

Duid op de schets de plaats van de aanwijsinrichting aan (X=Indicator)

Hoekbelasting : Charge d'angle	12 000	Eo :	0	Positie	Ic	Ec	MTF/EMT
	1	12 000	0	40			
	2	12 000	0	40			
	3	12 002	2	40			
	4	12 000	0	40			
	5	11 998	-2	40			
	6	12 004	4	40			

Rollende last : Charge roulante	29 536	Eo :	0	Positie	Ic	Ec	MTF/EMT
	A -->	29 546	10	40			
	B -->	29 540	4	40			
	C -->	29 538	2	40			
	C <--	29 540	4	40			
	B <--	29 542	6	40			
	A <--	29 546	10	40			

Substitutielast Charge de substitution	Aanwijzing I	Toegevoegde last dL	Gemeten waarde G=I+1/2e-dL	Fout op dit punt E	Werkelijke last L=G-E
Last/Charge 1	29 794		29 794	10	29 784
Last/Charge 2	29 546		29 546	10	29 536

Datum/Date : **12/11/2020**

Inspecteur : **Stijn Deswaef**

Elektronische handtekening
Signature électronique

Alle informatie op dit document wordt als vertrouwelijk behandeld (Verkoopsvoorwaarden, artikel 14). Toutes les informations sur ce document sont traitées de manière confidentielle (Conditions de vente, article 14). Dit document mag alleen in zijn geheel gereproduceerd worden. / Ce document ne peut être reproduit que dans son entiereté.